

CBG <small>Das Institut für anatomische und physiologische Arbeitswissenschaft</small>	Model	Mikrotiterplattenhalter
	Baujahr	2009
	S/N	1
	Spannung	24VDC
	Frequenz	
	Sicherung	

SIEMENS

LOGO! 12/24RC 6ES1 062-1WD00-0BA5

ESC OK






CBG Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics WORKSHOP	Model	Mikrotiterplattenhalter
	Baujahr	2009
	S/N	1
	Spannung	24VDC
	Frequenz	
	Sicherung	


SIEMENS

LOGO! 12/24RC

ESC OK

6ES7 302-1ED00-0AA0

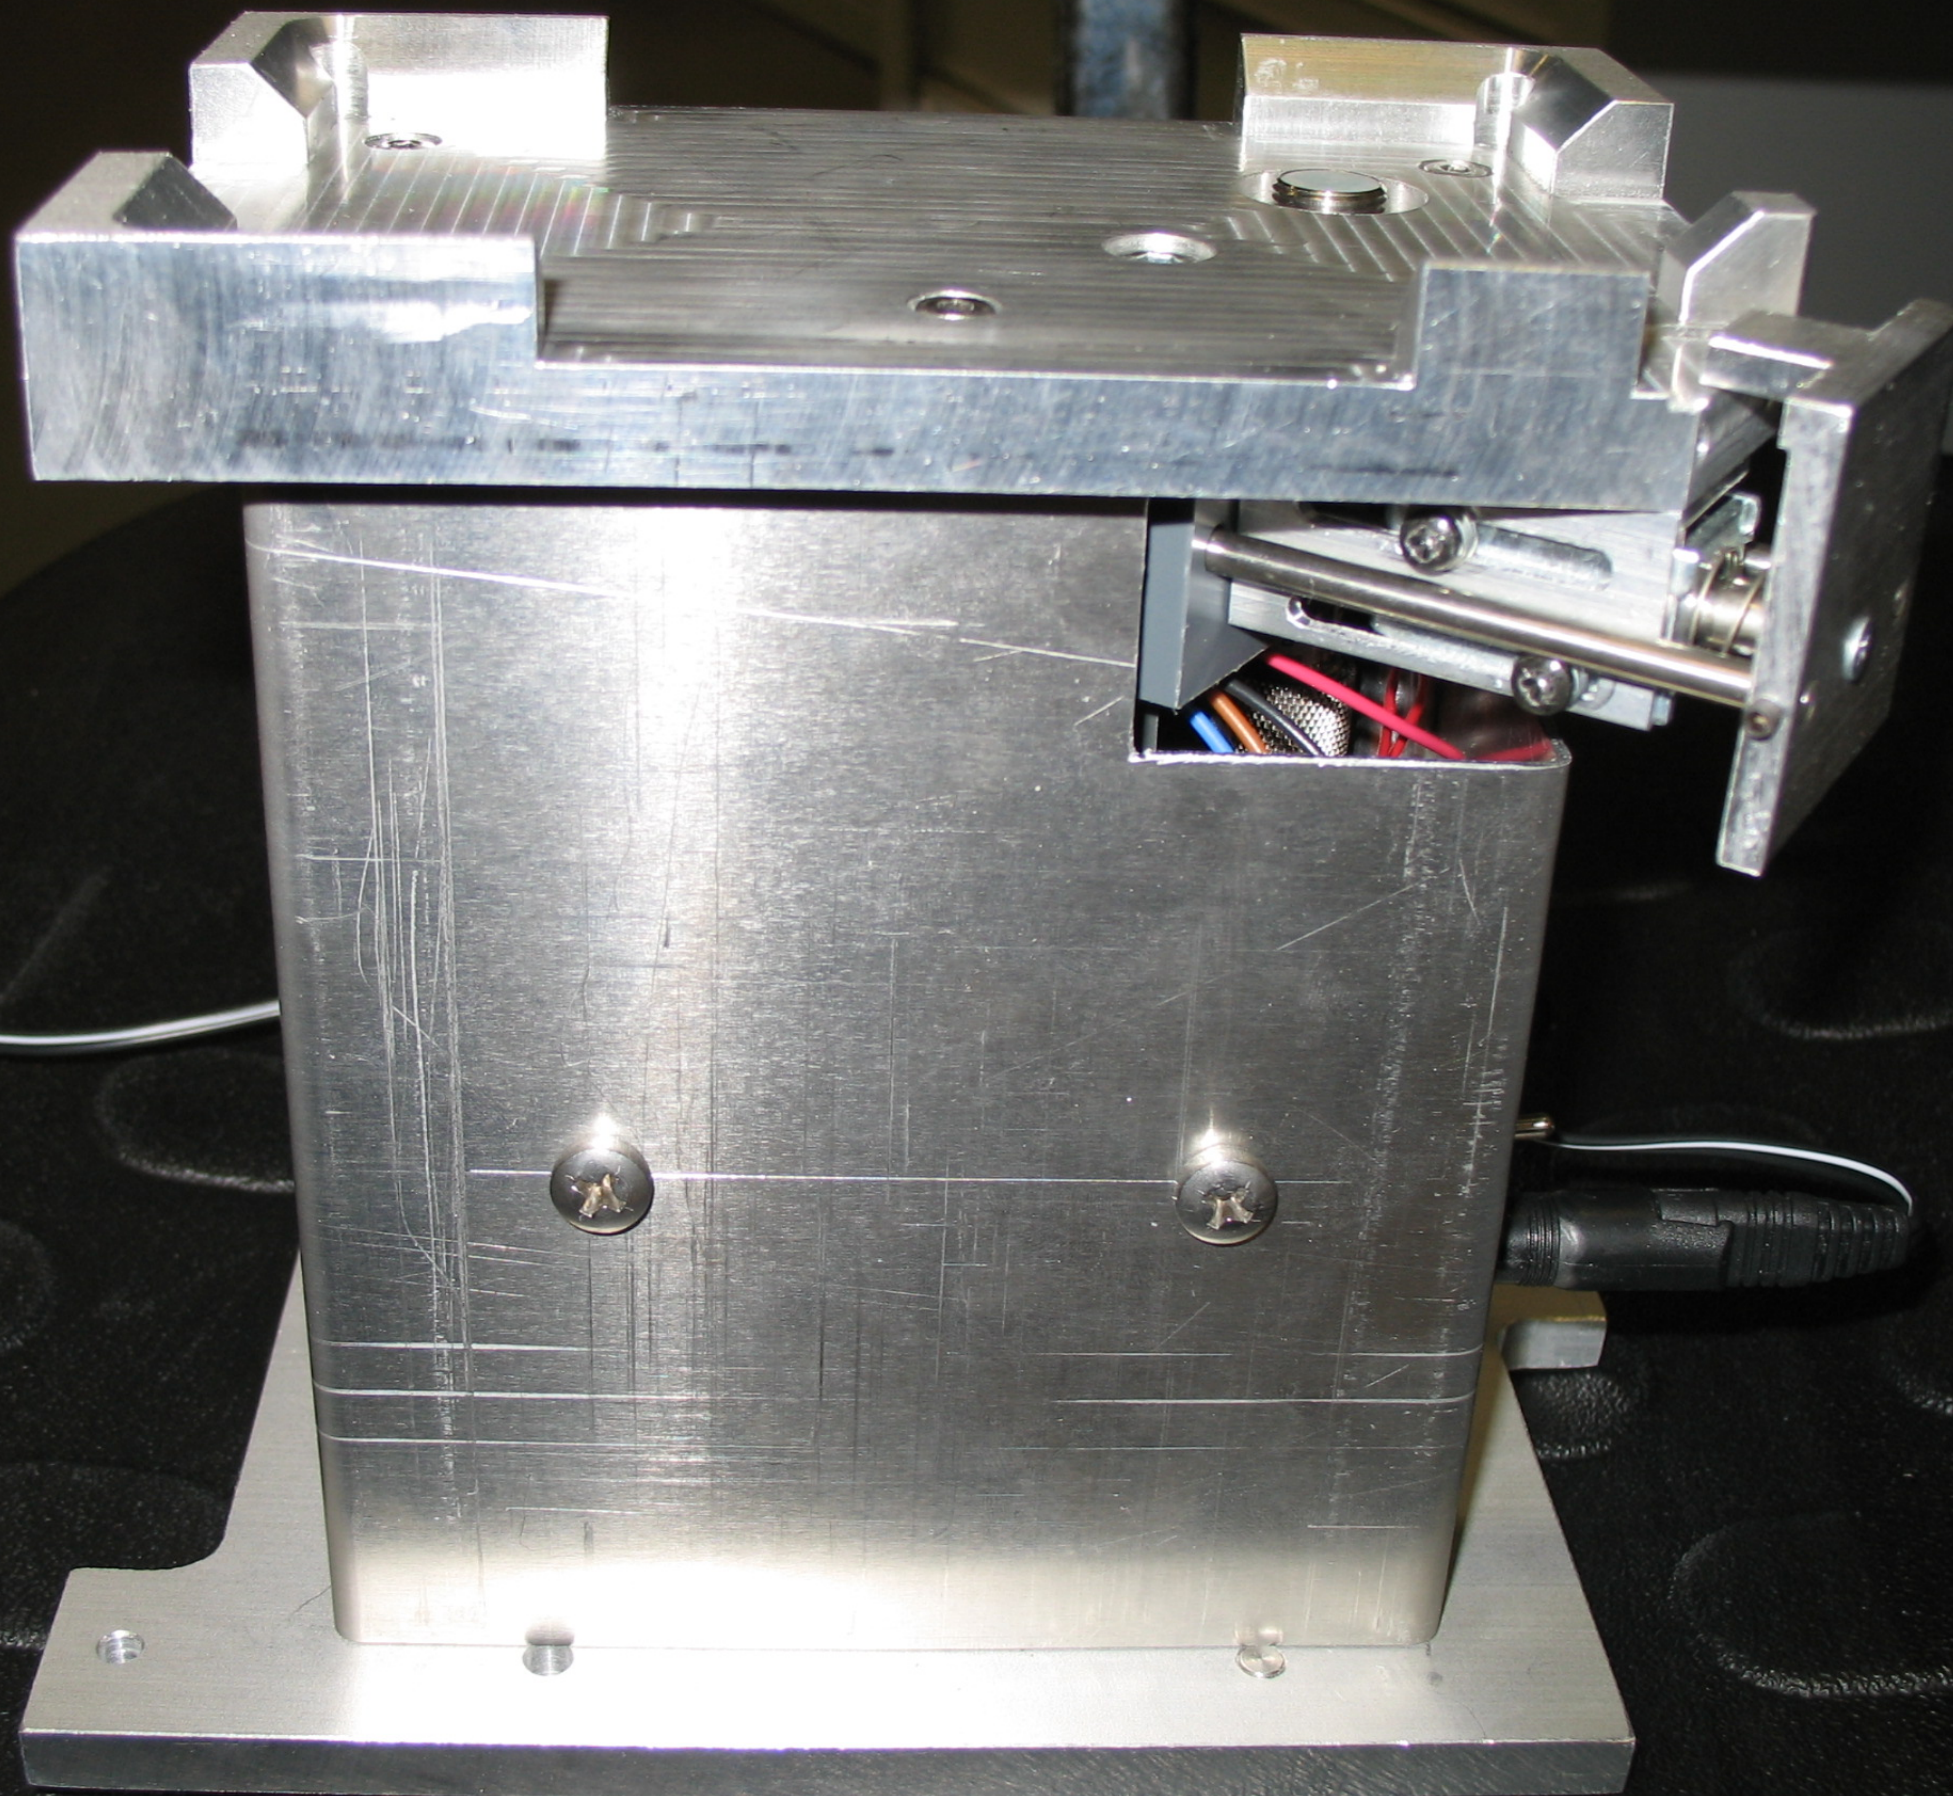

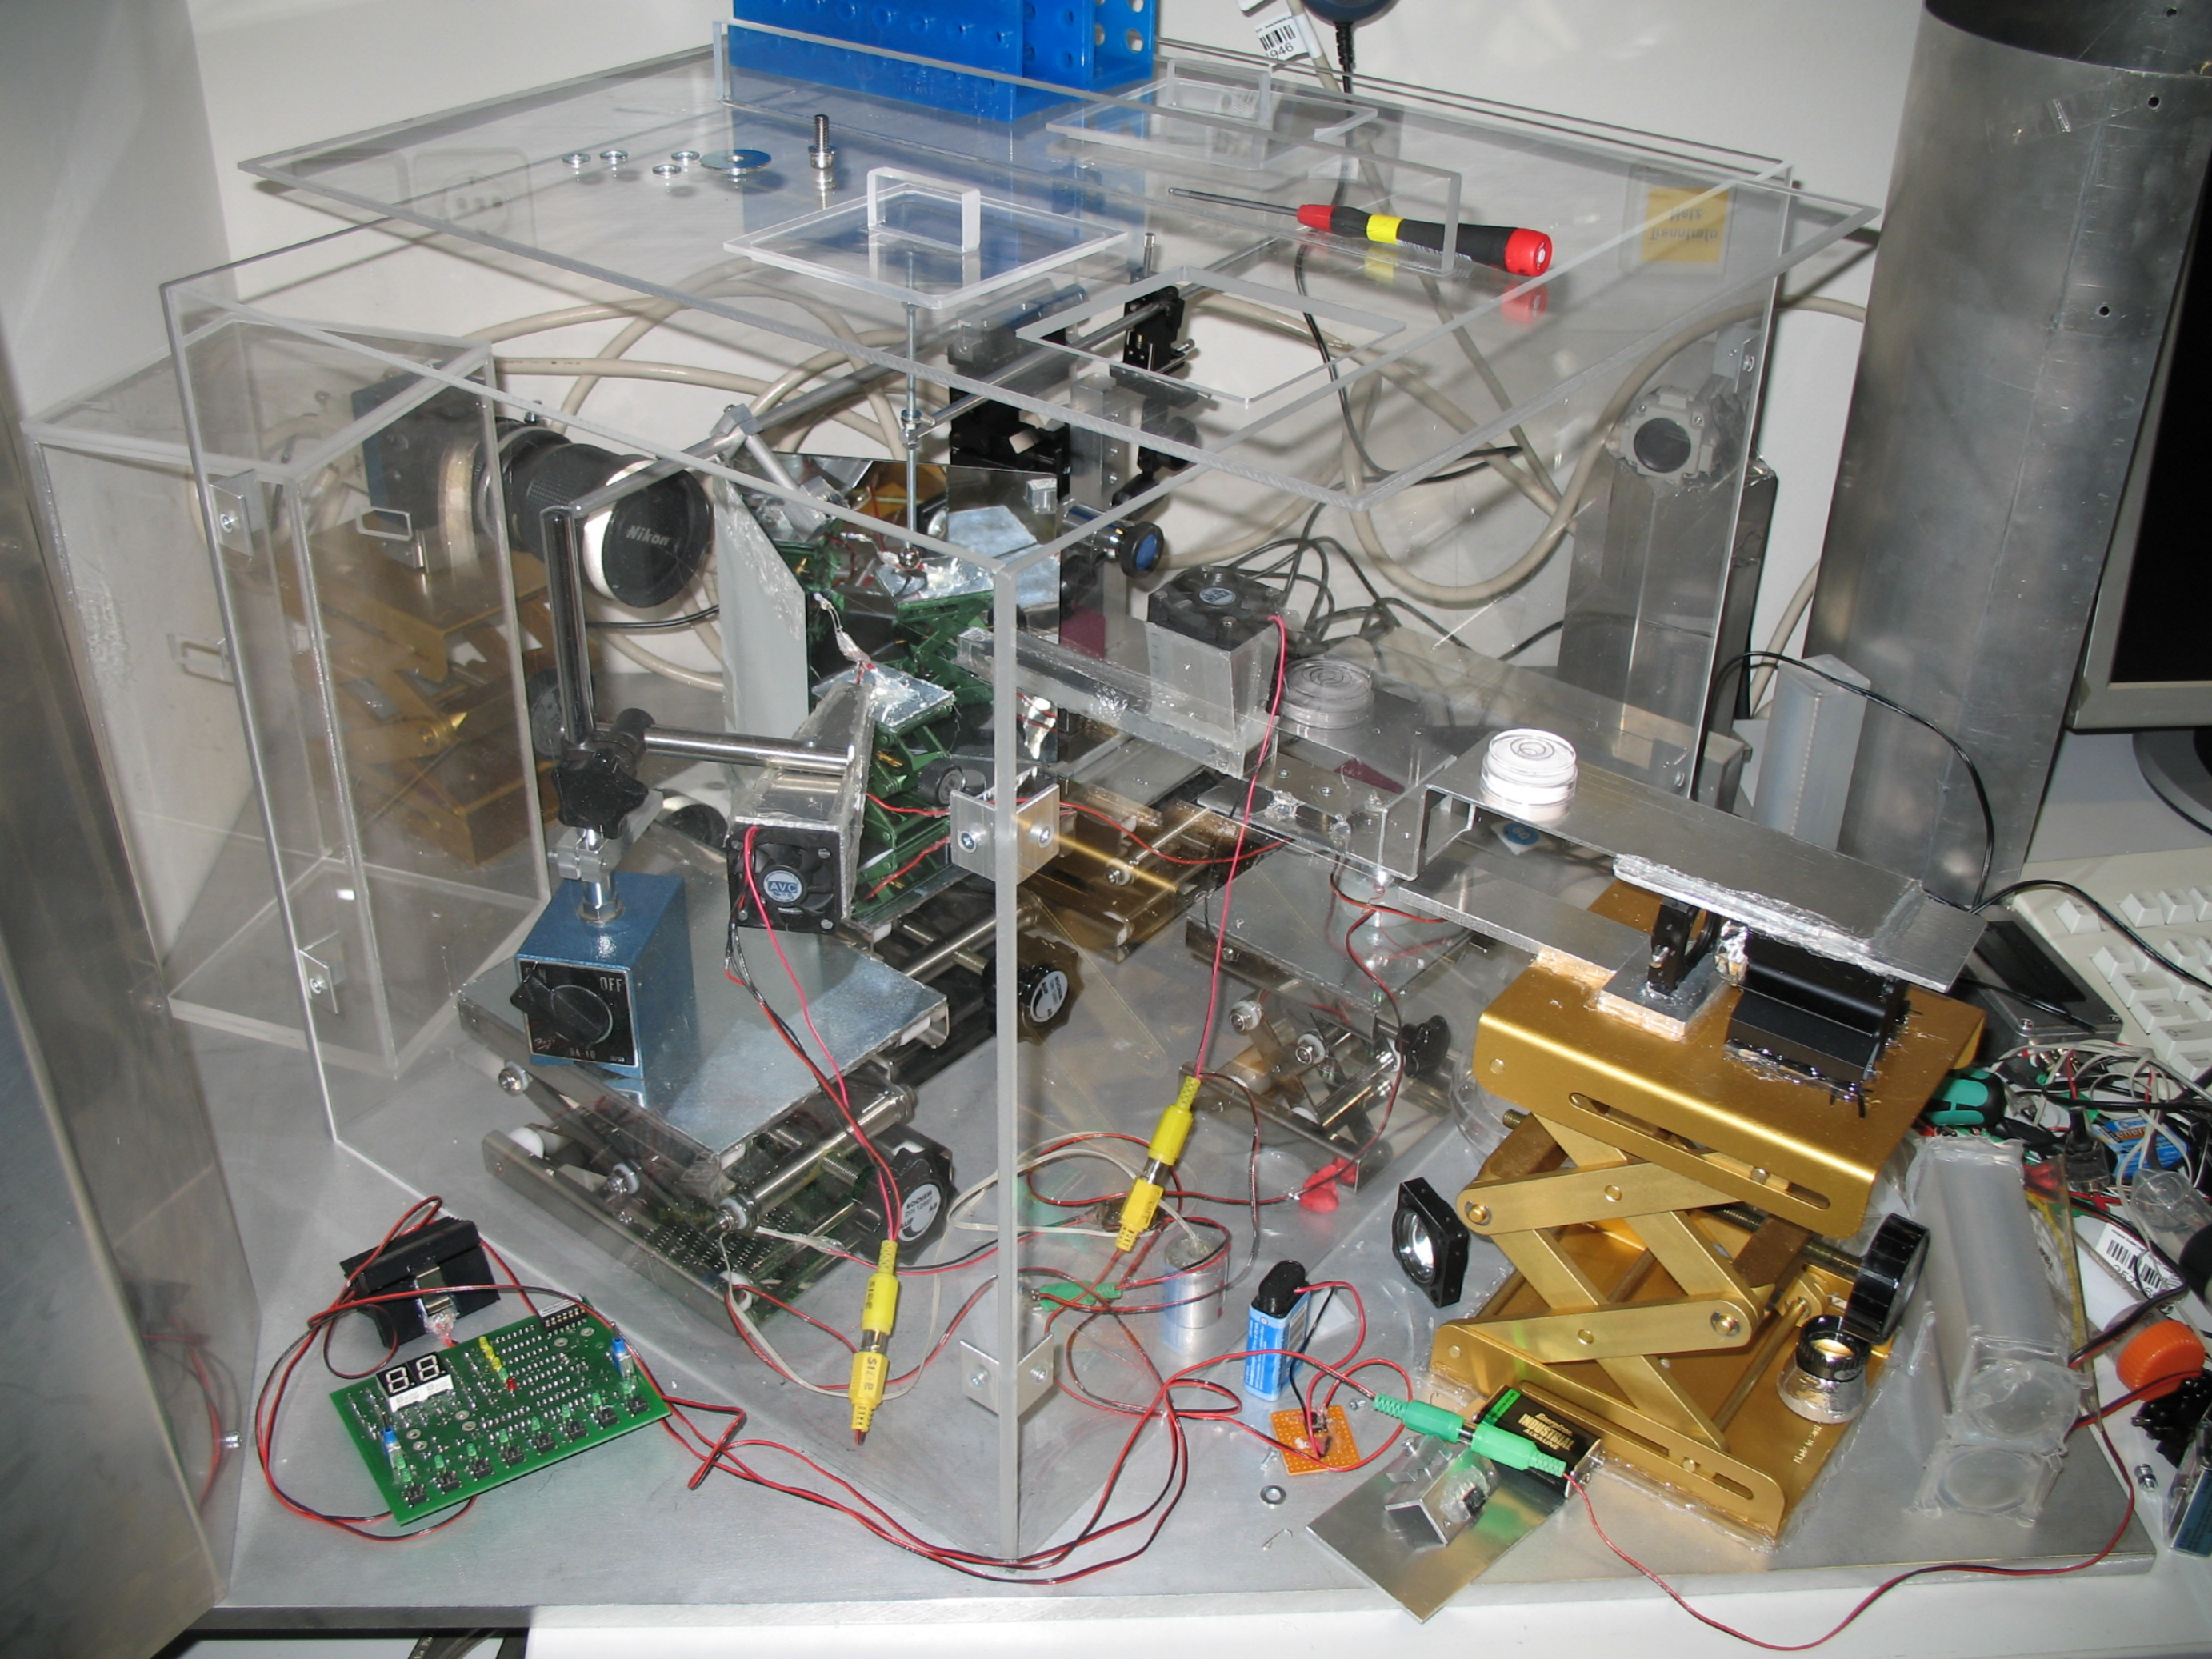



301802-41


Reparaturtreff (031) 382572 www.rctrek.org
2284368
Achtung! Vor jeder Inbetriebnahme ist eine Stromprüfung vorzunehmen. Bei Beschädigung von Geräten sind diese sofort aus dem Einsatz zu nehmen. Bei Unfällen, die durch elektrische Stromschläge verursacht werden, ist sofort ein Arzt zu rufen.
09

Vor Öffnen des Netzstecker
Before opening disconnect
Avant d'ouvrir retirez la fiche



Fan Speed
Controller
Power
Fuses T6.3A



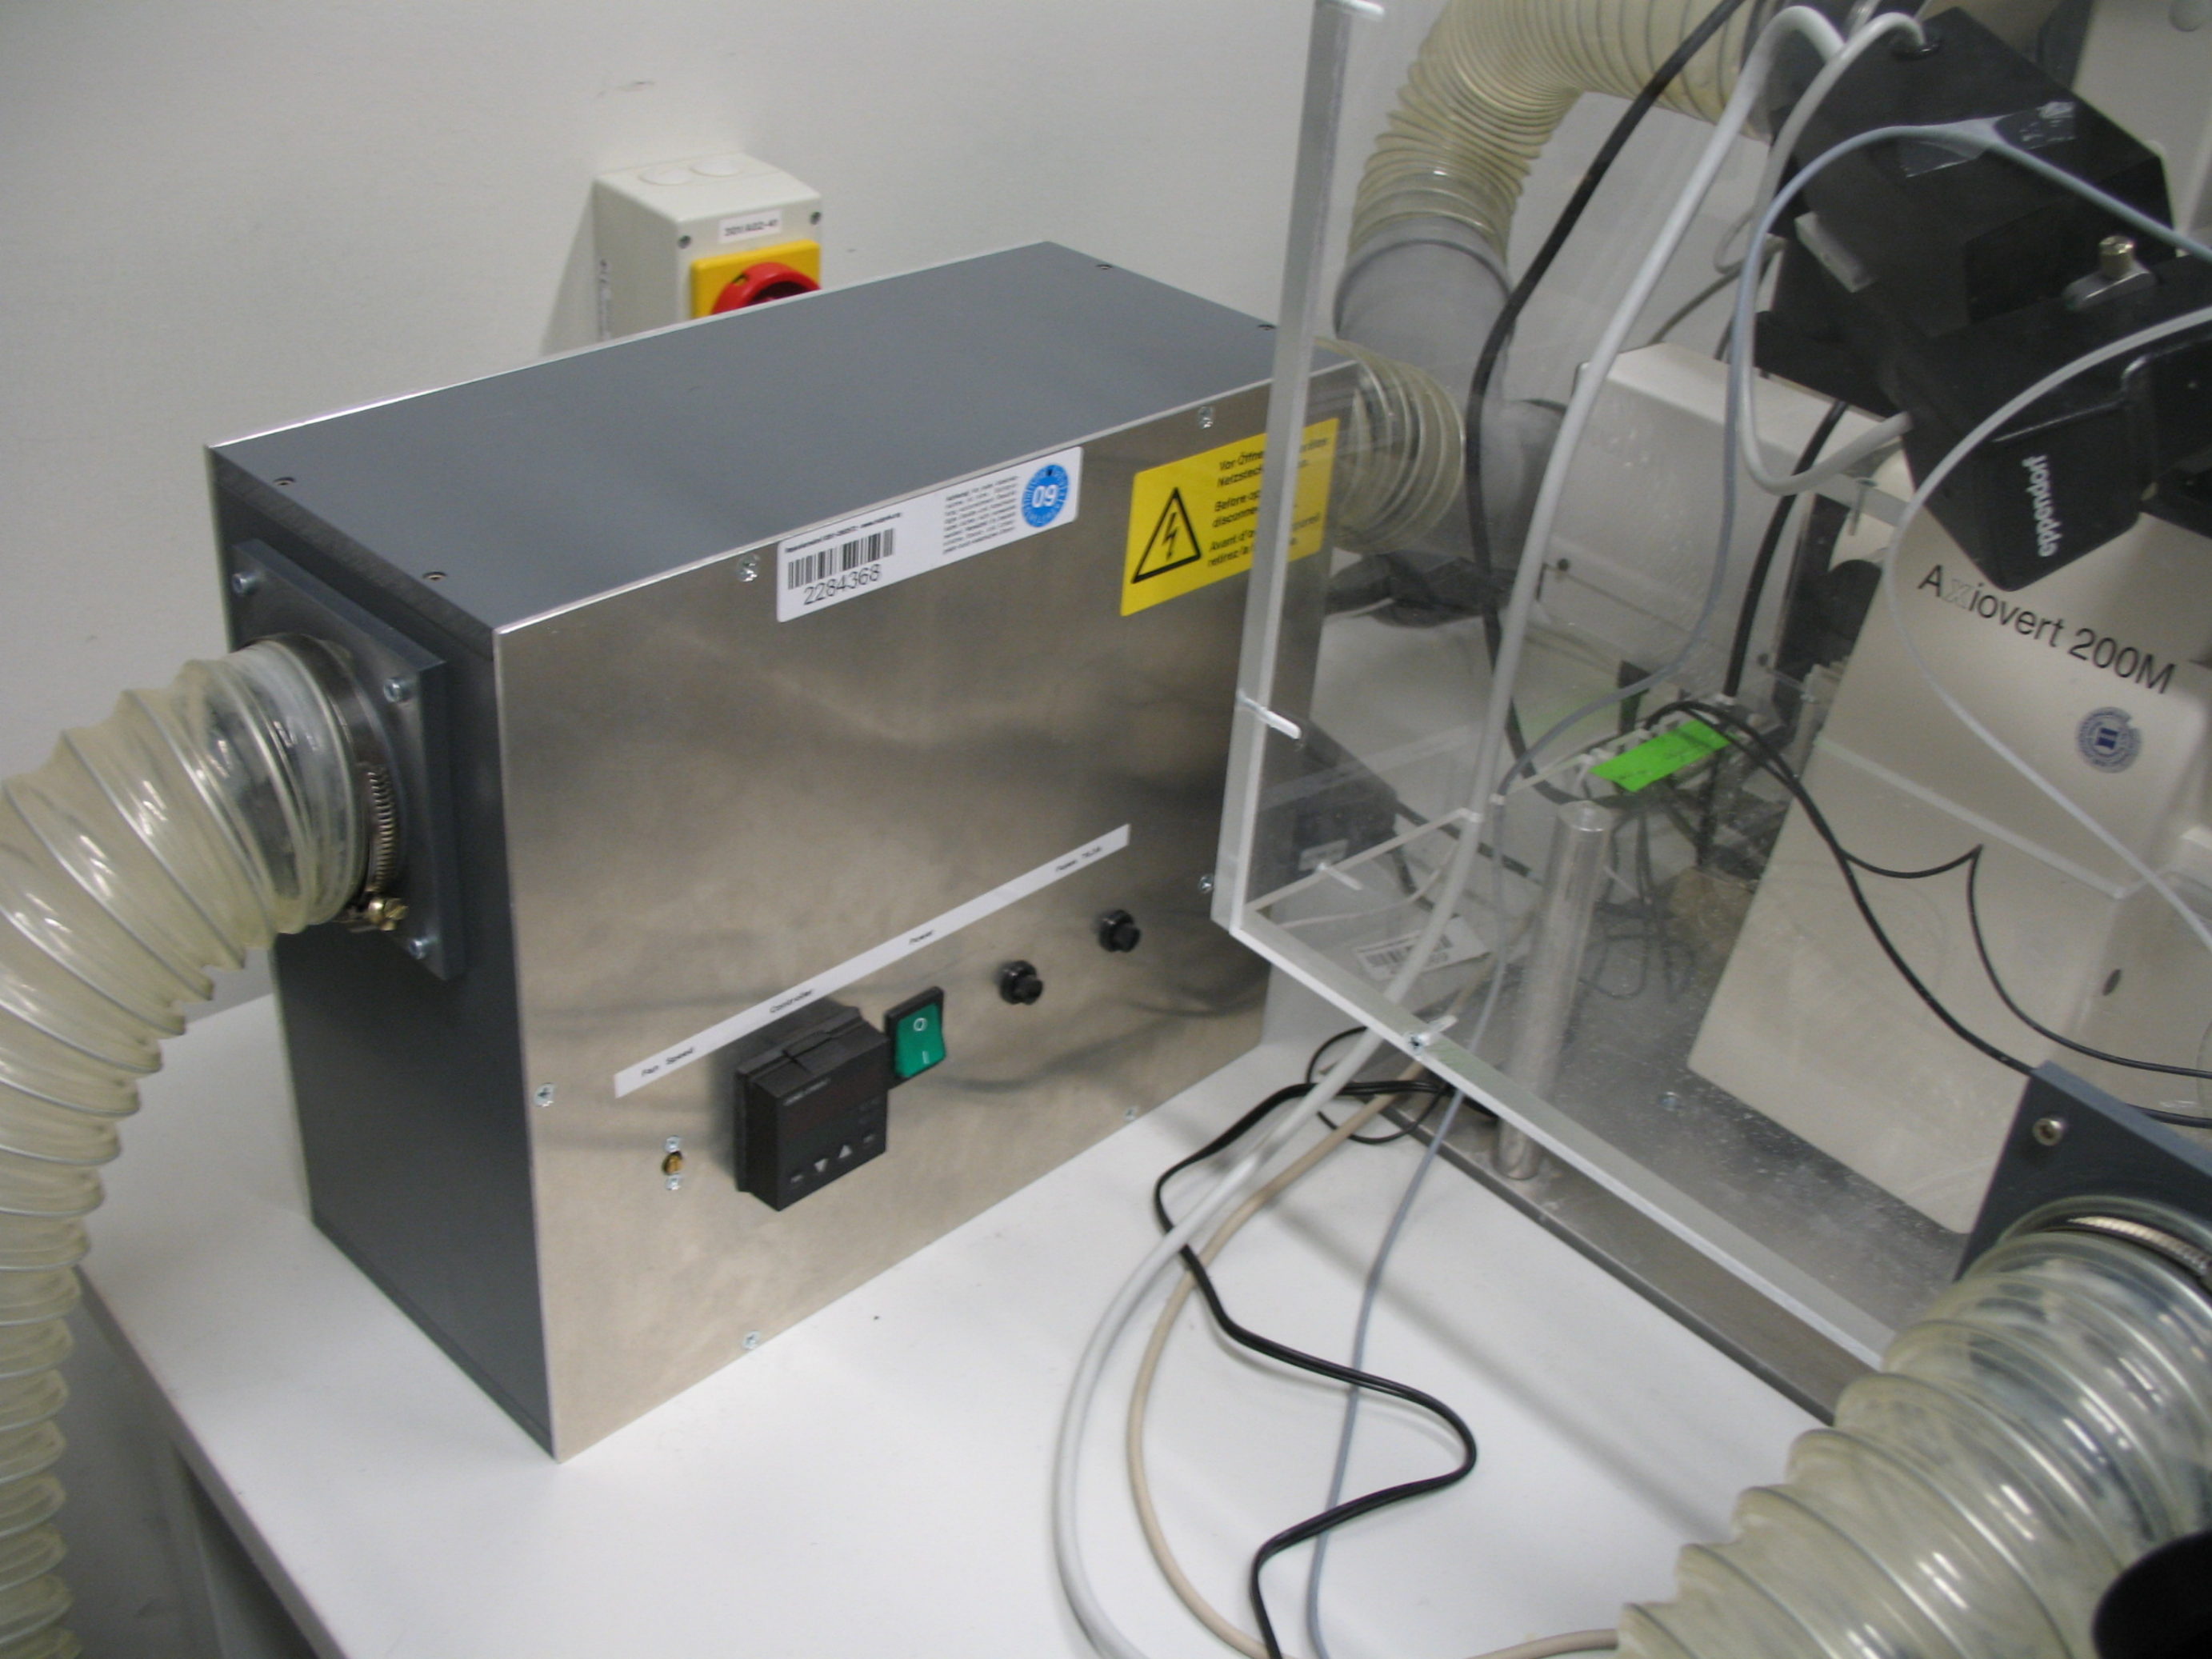

2284368

Vor Öffnen Netzschalt
Before disconnec
Avert d'op
retire d'

Axiobert 200M

erpendorf

Microscope Axiovert 200M

MPI für mol. Zellbiologie
MOEG04049060030





0180 333 6 335
mikro.service@zeiss.de
SIP 46772




0063689*

Cobolt Calypso™

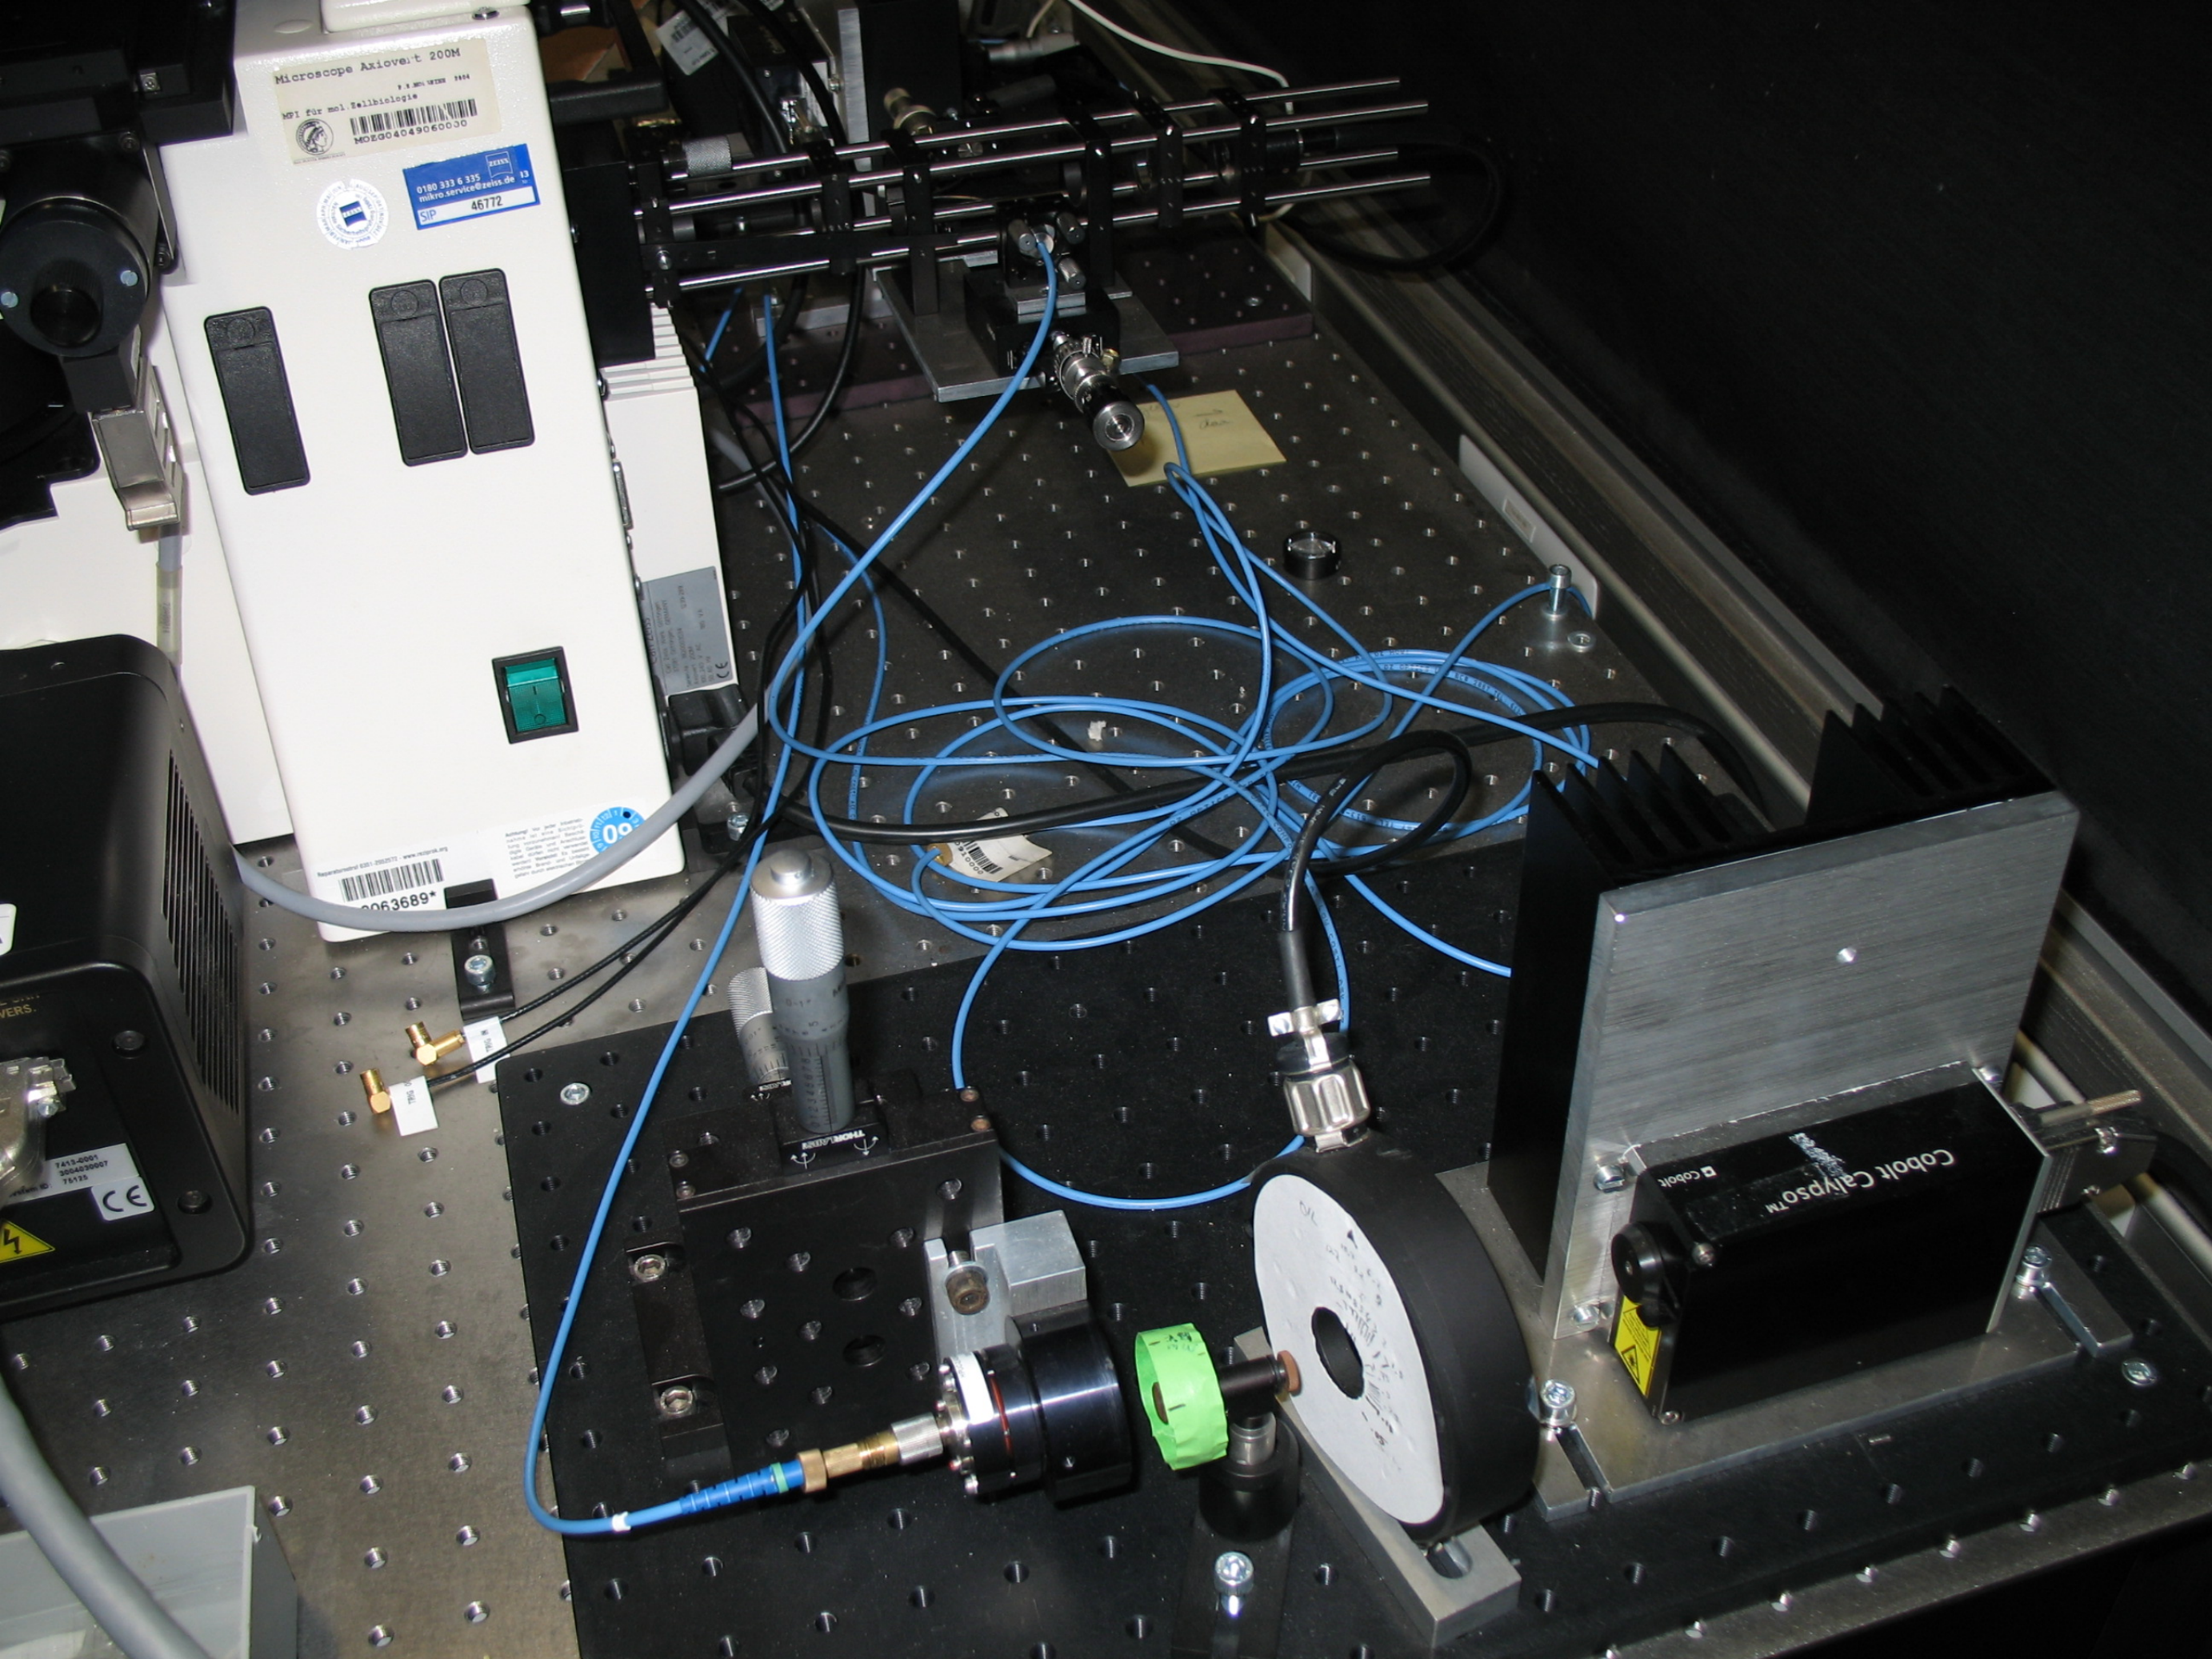

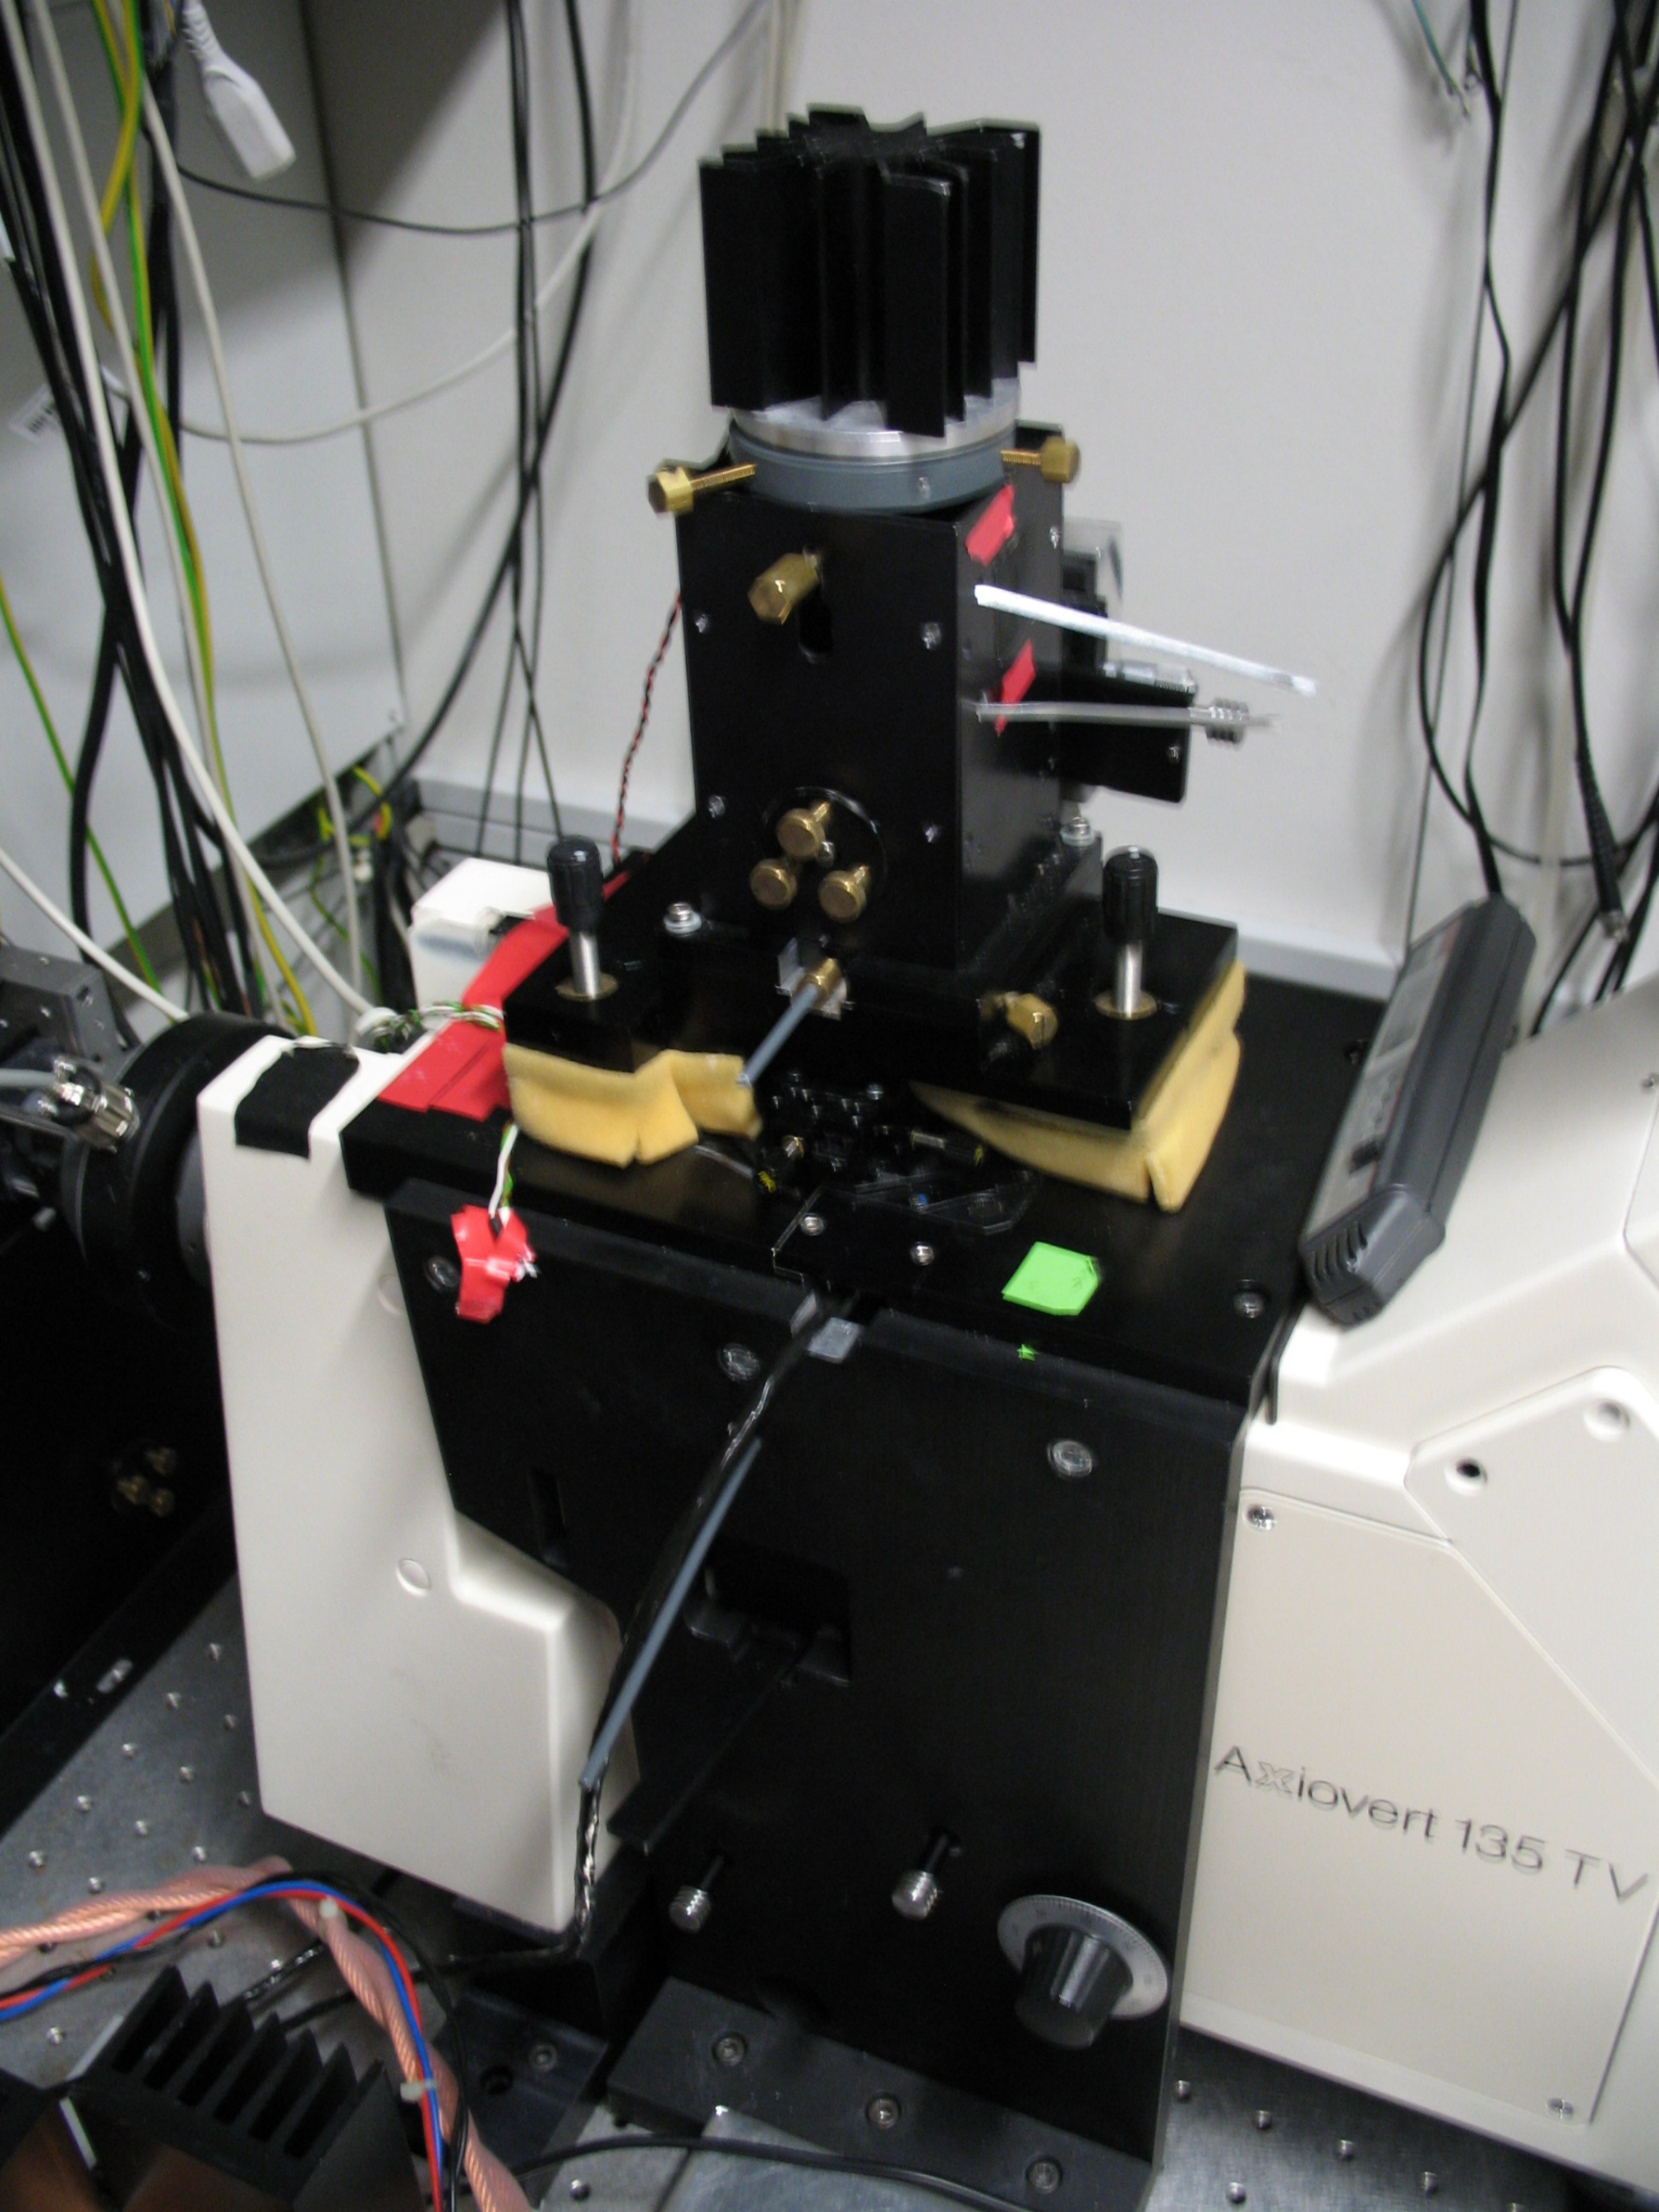


Axiovert 135 TV

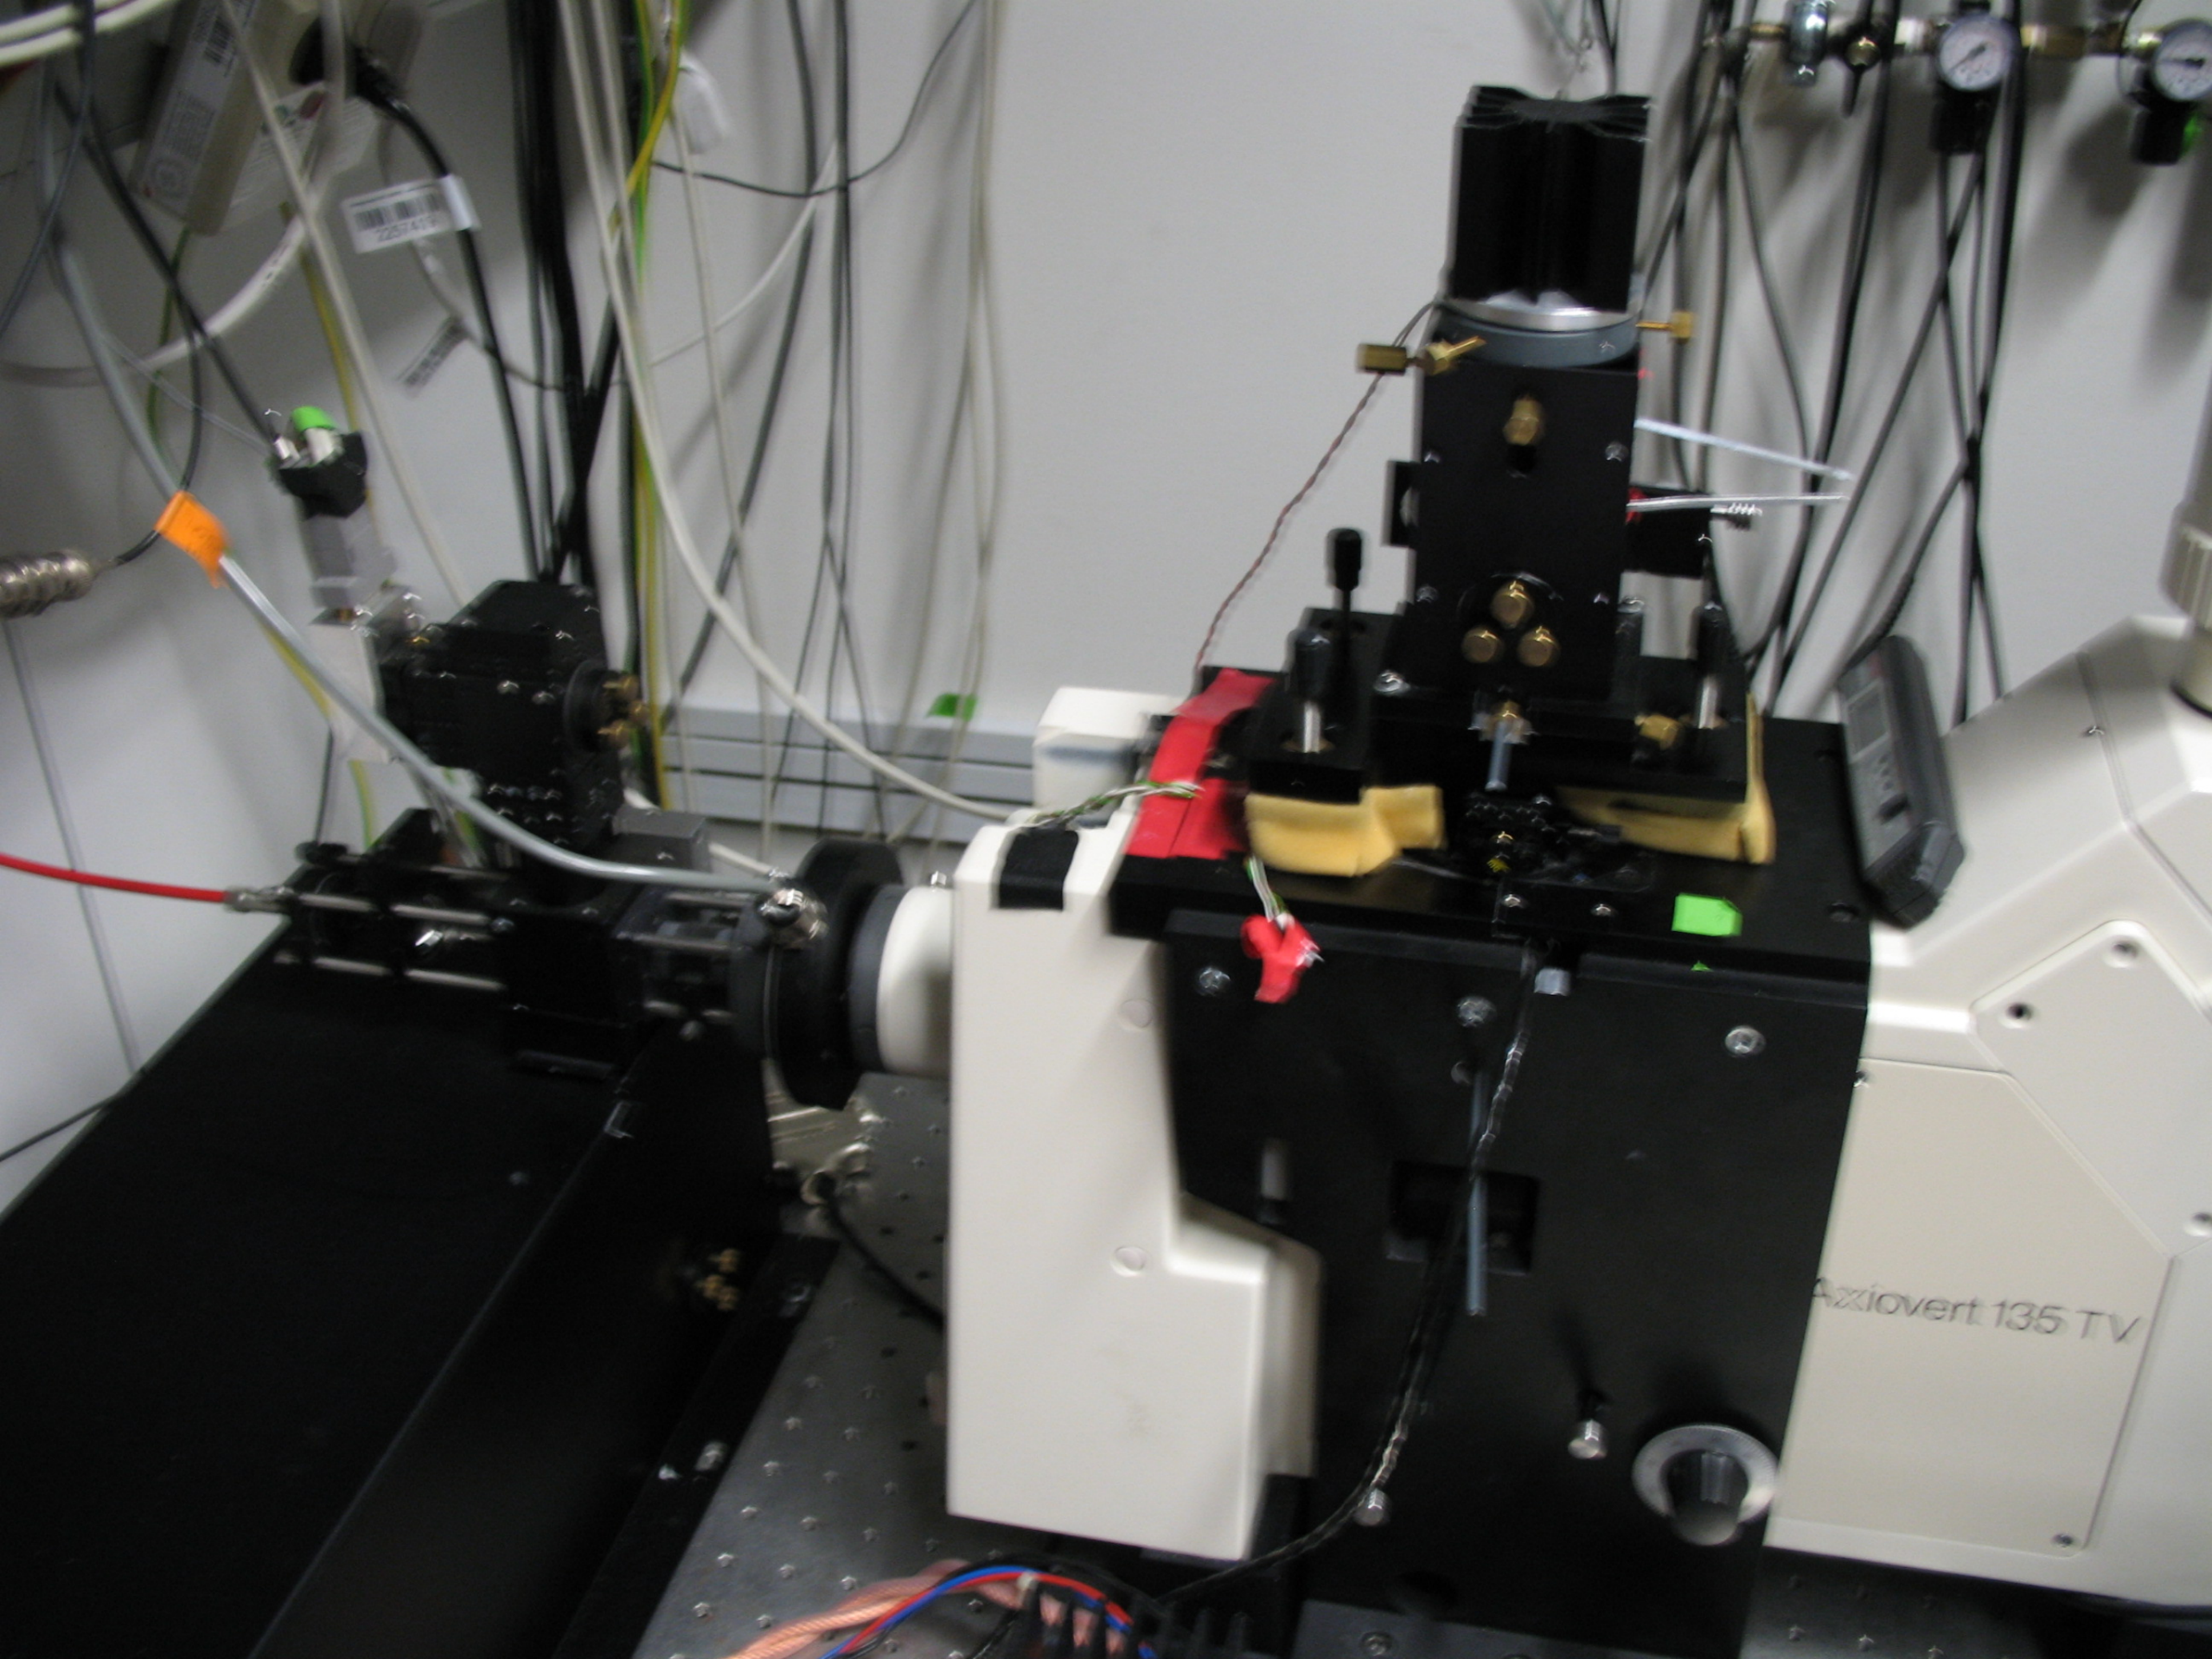

Axiovert 135 TV

225419

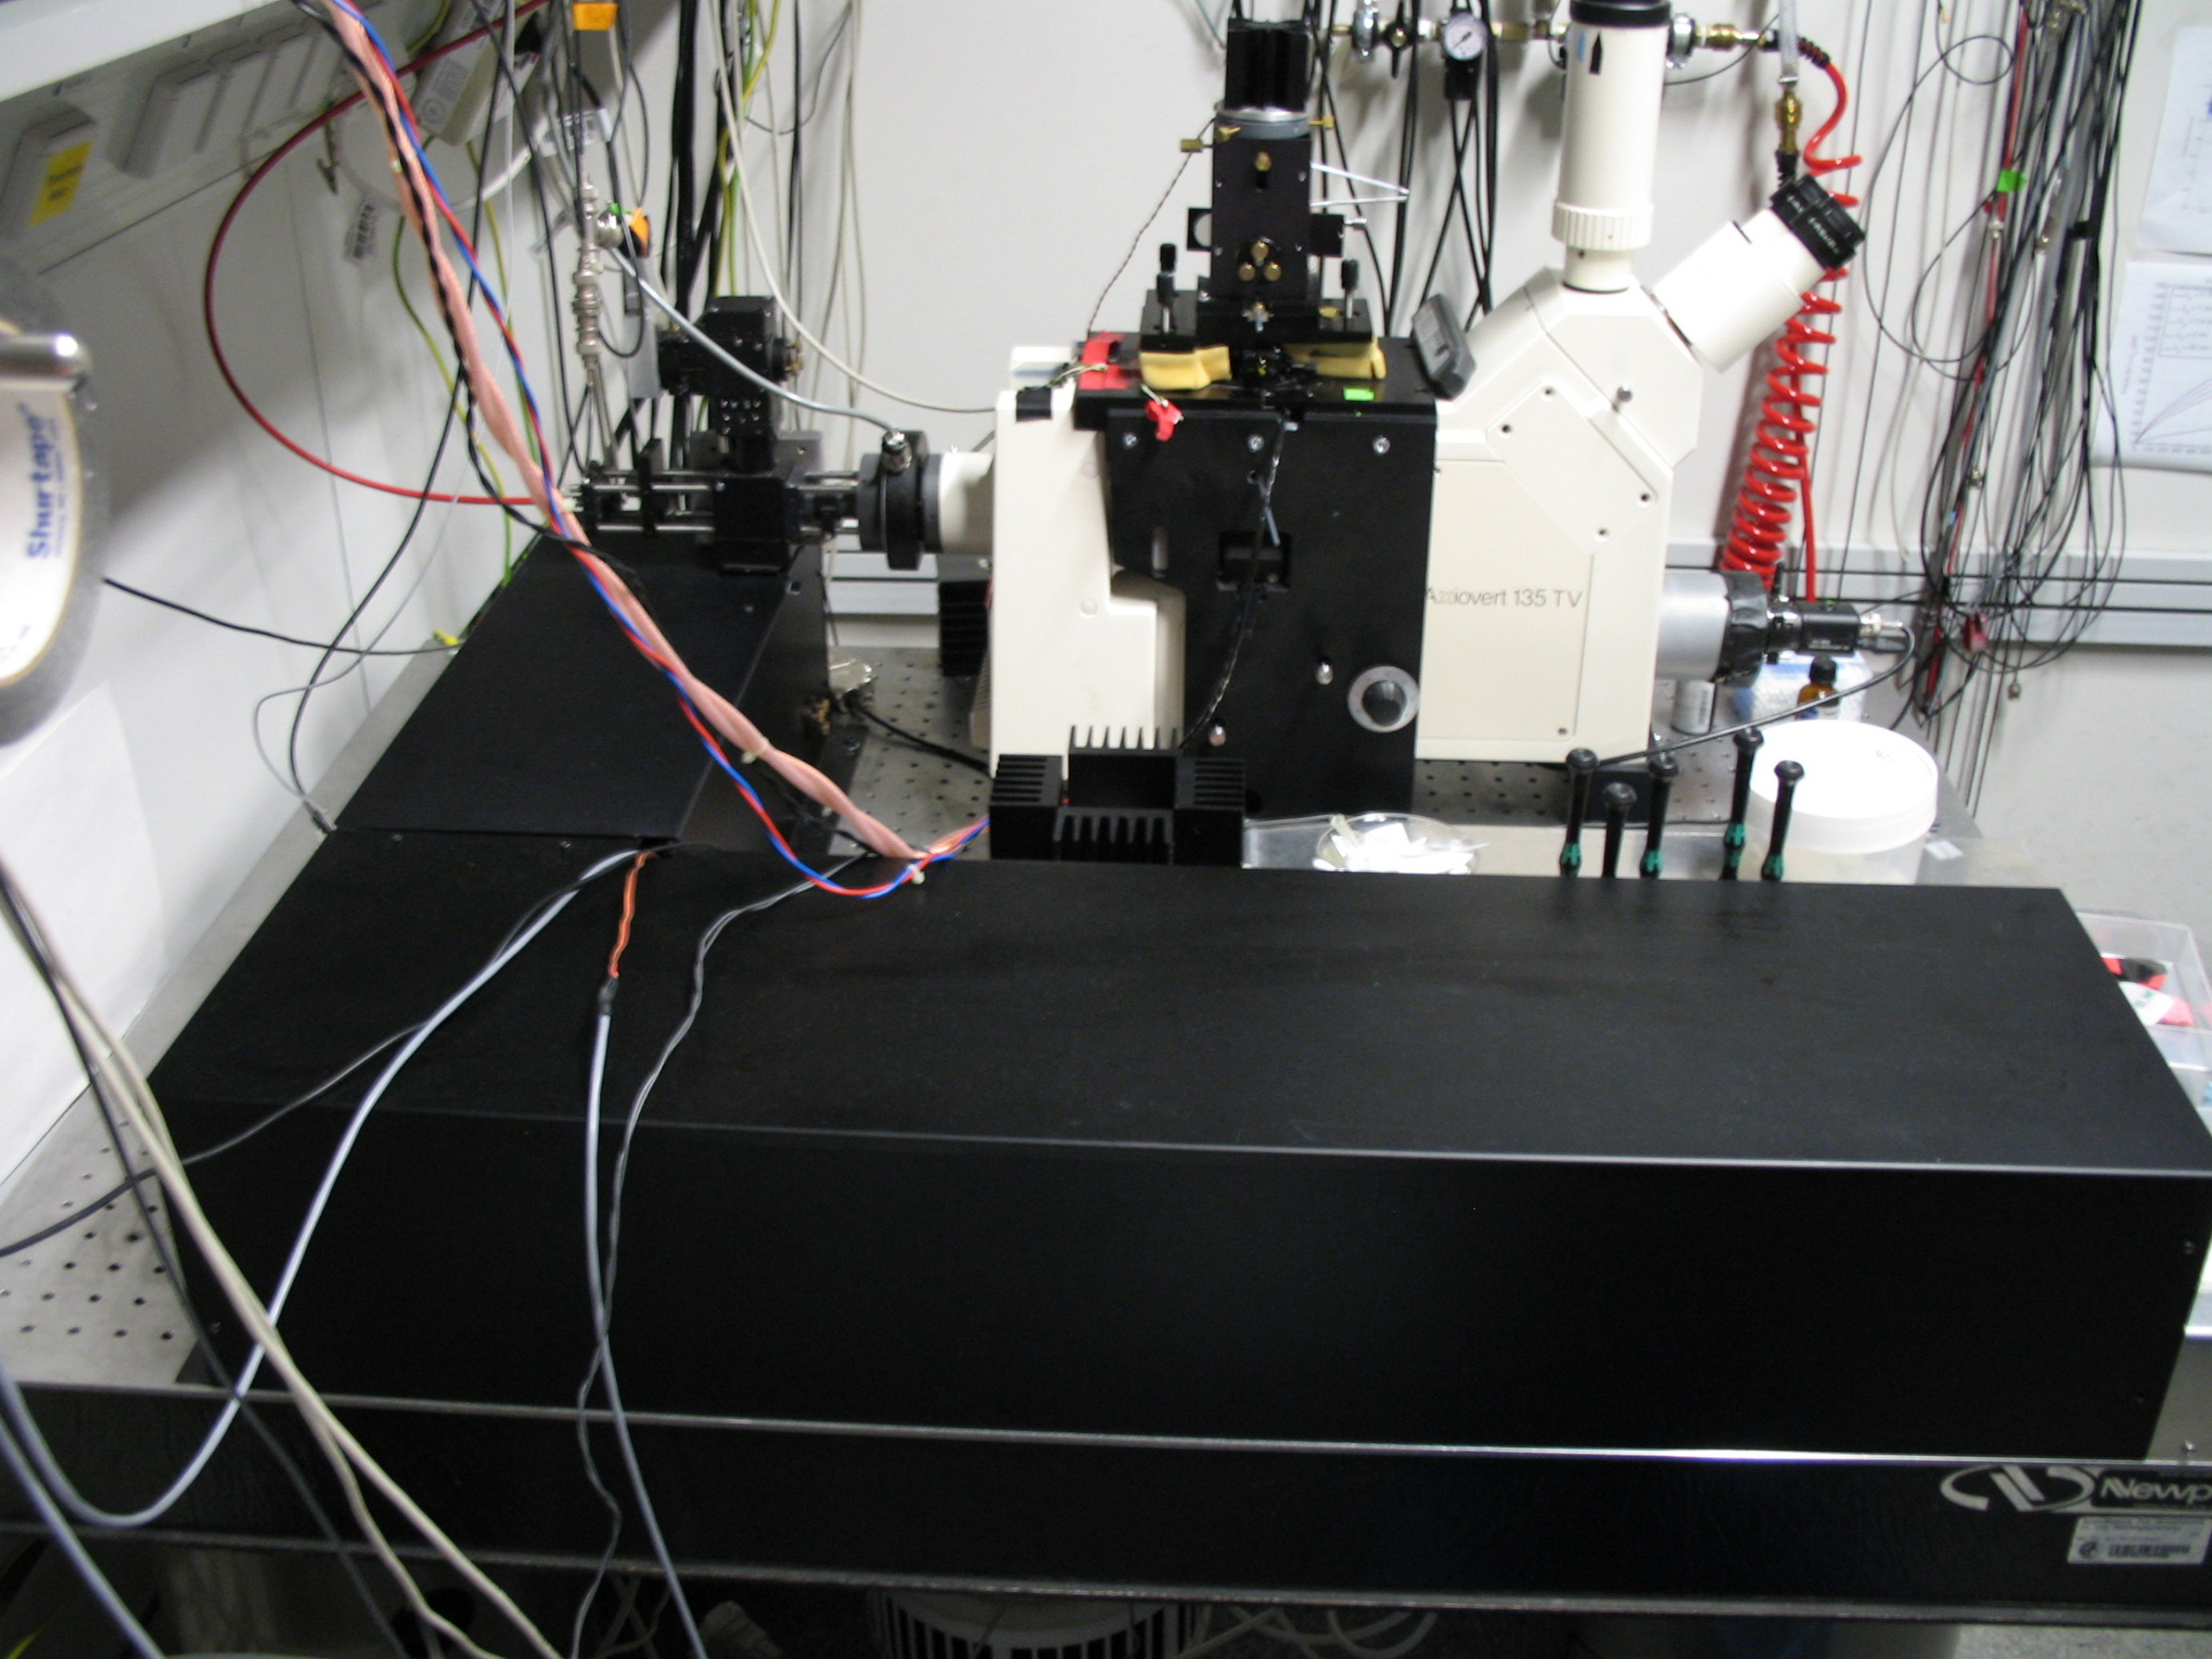

Axiiovert 135 TV

Newport

